

BioStamp



MANUAL DE INSTRUÇÕES

► **ÍNDICE**

1 - Introdução.....	1
2 - Conteúdo da embalagem.....	1
3 - Instalação.....	1
4 - Instruções de uso.....	1
5 - Problemas e soluções.....	2
6 - Manutenção e limpeza.....	2
7 - Especificações técnicas.....	3
8 - Simbologia.....	3
9 - Termo de garantia e assistência técnica.....	3
10 - Representante autorizado na Europa.....	4
11 - Declaração de conformidade.....	4
12 - Cuidados de proteção do usuário.....	4
13 - Instrução para armazenamento do produto.....	4

► 1 - INTRODUÇÃO ◀

A Seladora BioStamp da Bio-Art possui tecnologia de aquecimento PTC (Positive Temperature Coefficient) para o controle eficaz da temperatura de selagem.

Trabalha com rolos de papel de até 300mm de largura, possui alavanca de acionamento com exclusivo sistema de trava do papel e lâminas para corte em ambas as direções.

► 2 - CONTEÚDO DA EMBALAGEM ◀

Seladora BioStamp (uma unidade).

Cabo elétrico 2p+T (uma unidade).

Manual de instruções (uma unidade).

► 3 - INSTALAÇÃO ◀


- A seladora é fabricada para voltagens 127 ou 220VAC não possuindo sistema de comutação bivolt e deve ser conectada em rede elétrica adequada à sua tensão, com aterramento e dispositivos de proteção bipolares.

- Para a instalação do rolo de papel basta acomodá-lo sobre a parte côncava do gabinete observando que a superfície plástica do papel permaneça para cima.

- Não instale a seladora na mesma tomada onde outros aparelhos, máquinas ou equipamentos já estejam instalados.

- Ao conectar o cabo de força na rede elétrica haverá um sinal sonoro "bip" indicando a presença de tensão elétrica.

► 4 - INSTRUÇÕES DE USO ◀

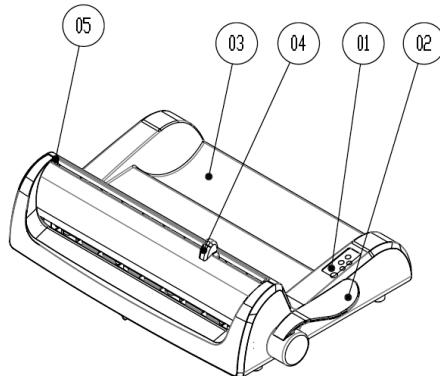

- 1 - Painel eletrônico;
- 2 - Alavanca de acionamento;
- 3 - Alojamento do rolo de papel;
- 4 - Carro das lâminas de corte do papel;
- 5 - Parafuso de fixação e liberação do trilho.

- 1- Para ligar a seladora BioStamp, acione a tecla Liga/Desliga no painel eletrônico [1]. O Led verde acenderá de forma intermitente indicando o tempo para o aquecimento da unidade de selamento;
- 2- Aguarde que o Led verde altere de forma intermitente para acesso contínuo indicando que a máquina está pronta para o uso;
- 3- Para efetuar o selamento, introduza o papel com a face plástica voltada para cima no interior do sistema de selagem através das aberturas no gabinete. Em seguida, acione a alavanca 180° no sentido anti-horário pressionando e travando o papel. Neste momento o Led vermelho acenderá continuamente indicando o início processo de selagem;
- 4- Aguarde o sinal sonoro "bip", quando o Led vermelho acenderá de forma intermitente, alertando que a selagem foi concluída com sucesso;
- 5- Caso necessário, o corte o papel deve ser feito com a alavanca acionada, deslizando a guilhotina até o final do curso;
- 6- Retorne a alavanca na posição inicial, quando o Led vermelho se apagará, indicando que a máquina está pronta para novo selamento.

Nota:

- O carro das lâminas da seladora corta o papel nos dois sentidos deslizando para ambos os lados em toda extensão do papel. A operação de corte deve ser realizada após a selagem e sempre com o papel pressionado;

- Não aione a alavancas com o Led verde aceso intermitente, caso isso ocorra haverá um sinal sonoro e luminoso do Led vermelho como alerta de que a seladora ainda não está na temperatura correta de selagem;
- Caso a alavancas não retorne em 10 minutos ou a máquina não seja aionada por 60 minutos a mesma será desligada como segurança.

► 5 - PROBLEMAS E SOLUÇÕES

PROBLEMAS	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
Selagem deficiente.	A seladora não liga ao aionar a tecla do painel eletrônico, Led verde permanece apagado.	Falta de energia na seladora.
		Seladora originalmente 220V trabalhando na rede 127V.
		Tempo de selagem deficiente.
		Resíduos obstruindo a unidade de selagem.
Papel queima e/ou o plástico derrete durante a selagem.	Seladora originalmente 127V trabalhando na rede 220V.	Verifique a voltagem da máquina de acordo com a rede elétrica.
	Tempo de selagem excessivo.	Retorne a alavancas no momento que o Led vermelho acender de forma intermitente.

► 6 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- 1- Para a limpeza do gabinete utilize apenas um pano seco macio e não use solventes, detergentes ou produtos químicos;
- 2- Não utilize objetos metálicos ou cortantes para a limpeza de qualquer parte da Seladora BioStamp;
- 3- Nenhuma manutenção na Seladora BioStamp deve ser executada pelo usuário, utilize sempre uma assistência técnica autorizada.

6.1- Substituição do fusível

- 1- Desconecte o cabo de alimentação da tomada e do conector de entrada antes de efetuar a substituição do fusível;
- 2- Introduza uma chave de fenda pequena no orifício da gaveta do porta-fusível localizado no conector de entrada (AC) forçando-a para fora e puxe a gaveta do porta-fusível;
- 3- Observe a existência de dois fusíveis, sendo que o fusível localizado mais internamente na gaveta deve ser substituído pelo reserva, localizado logo antes deste;
- 4- Retorne a gaveta dos fusíveis até encaixá-la completamente;
- 5- Retorne o cabo de alimentação e ligue a máquina para verificar seu funcionamento correto.

Atenção:

- Caso o fusível volte a apresentar problemas, procure à Assistência Técnica Autorizada;
- Mantenha sempre como reserva um fusível na gaveta porta fusível e utilize apenas fusível normalizado Ø5x20mm 6A/250V.

6.2- Substituição das lâminas de corte do papel. CUIDADO AO MANUSEAR AS LÂMINAS!

Para a substituição das lâminas de corte do papel não é necessário desmontar o gabinete da máquina, siga os procedimentos abaixo e retire apenas o conjunto do carro da lâmina para a devida substituição das lâminas de corte.

- 1- Desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de iniciar o procedimento;
- 2- Deslize o carro das lâminas (04) até o centro do trilho. Em seguida, empurre a guia e retire o conjunto cuidadosamente;
- 3- Apoie o carro da lâmina sobre uma superfície plana e firme. Utilize uma chave Philips para remover o parafuso da tampa de fixação;
- 4- Com cuidado, retire as lâminas usadas e instale as novas. Certifique-se de que estejam corretamente encaixadas na posição indicada;
- 5- Após a substituição, reposicione a tampa e aperte o parafuso com firmeza;
- 6- Empurre novamente a guia e insira o carro das lâminas no centro do trilho. Verifique se as lâminas estão devidamente encaixadas na fenda interna da seladora;
- 7- Por fim, deslize o carro completamente para a direita, concluindo o encaixe.

ATENÇÃO! As lâminas são muito afiadas, é necessário cuidado ao manuseá-las.



► 7 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de Alimentação.....	127 ou 220VAC 50/60Hz
Potência de trabalho.....	300W (máximo)
Resistência.....	PTC: Positive Temperatura Coefficient
Largura da solda.....	12mm
Tempo de aquecimento inicial.....	3'30" minutos
Tempo de soldagem.....	06" segundos
Comprimento da solda.....	300mm (máximo)
Dimensões da máquina (WxDxH).....	460 x 300 x125 mm
Dimensões da embalagem (WxDxH).....	500 x 320 x 160mm
Peso sem embalagem.....	3.600 Kg
Peso com embalagem.....	4.600 Kg

► 8 - SIMBOLOGIA



► 9 - TERMO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A BIO-ART Equipamentos Odontológicos Ltda., fornece garantia de 01 (um) ano para este produto a partir da data de sua aquisição. Esta garantia abrange todo e qualquer defeito de fabricação, sendo prestada através de conserto do equipamento que esteja condicionado aos seguintes requisitos:

- Que o produto tenha sido utilizado corretamente, de acordo com as instruções descritas no manual de instruções;
- A reclamação seja acompanhada da fatura de compra e registrada dentro do período de garantia, seguida de um relatório com descrição do defeito e número serial do produto;
- O produto seja utilizado, transportado e armazenado com cuidado;
- O custo de transporte (ida e volta) seja pago pelo cliente;

Limitações da garantia:

- Desgaste natural de peças;
- Mau-uso, quedas ou sinistros;
- Transporte inadequado;
- Reparo por pessoas não autorizadas;
- Utilização em desconformidade com as características e finalidades do produto;
- Desgastes por exposição a condições adversas (umidade, frio e calor intenso);
- Danos devido a falta de limpeza ou manutenção com produtos inadequados;

Em caso de dúvidas, consulte o fabricante:



BIO-ART EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

Rua Teotônio Vilela, 120 – Jardim Tangará – CEP 13568-000 – São Carlos – SP – Brasil
Tel. +55 (16) 3371-6502 – Fax +55 (16) 3372-5953 – www.bioart.com.br
CNPJ 58.538.372/0001-56 – Insc. Estadual 637.034.447.113

► 10 - REPRESENTANTE AUTORIZADO NA EUROPA

Obelis s.a.

EC REP

Boulevard Général Wahis 53 - 1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +(32) 2.732.59.54 - Fax: +(32) 2.732.60.03
E-mail: mail@obelis.net

► 11 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Esta máquina cumpre todas as disposições relevantes da Diretiva do Conselho Europeu 2006/42/CE (Máquinas); da Diretiva 2014/30/UE de 26 de fevereiro de 2014 (Compatibilidade eletromagnética) e da Diretiva 2014/35/UE de 26 de fevereiro de 2014 (Baixa tensão).

Normas Europeias harmonizadas para as quais a Conformidade é Declarada:

ISO 12100:2010 - Safety of Machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction;

IEC/CISPR 14-1 Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission;

IEC/CISPR 14-2 IEC/CISPR 14-2 Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity – Product standart;

EN 61000-4-2 Electrostatic discharge;

EN 61000-4-4 Electrical Fast transient and burst;

EN 61000-4-6 Conducted disturbance induced by RF fields;

EN 61000-4-5 Surges test;

EN 61000-4-11 Electromagnetic compatibility (EMC) Testing and measurement techniques;

IEC 61010-1:2010 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General requirements;

IEC 61010-2:2003 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-010: Particular requirements for laboratory equipment for the heating of material.

► 12 - CUIDADOS DE PROTEÇÃO DO USUÁRIO

O usuário deve ter cuidado ao manusear e evitar o contato de qualquer parte do corpo com as partes quentes e cortante.

► 13 - INSTRUÇÃO PARA ARMAZENAMENTO DO PRODUTO

Esse produto deve ser armazenado em local coberto, em temperatura ambiente, protegido contra quedas e impactos accidentais.



Rua Teotônio Vilela, 120 - Jd. Tangará - CEP 13568-000 - São Carlos - SP - Brasil

Tel. +55 (16) 3371-6502 - Fax +55 (16) 3372-5953

www.bioart.com.br